progetti
Medical Equipment Solutions
www.progettimedical.com
info@progettimedical.com
PROGETTI s.r.l. Via Bruno Buozzi, 28 • 10024 MONCALIERI (TO) ITALY • Tel. +39 011 644 738 FAX +39 011 645 822 • P. IVA IT06367590012 C.F. 10213970154

RESCUE SAM TRAINER PRO

USER MANUAL-Version 1.0 June2011

UK/GER

Product Introduction

The RESCUE SAM TRAINER PRO with Replaceable

Language/Scenario Card is designed to effectively train emergency responders in the use of an automated External Defibrillator (AED).This training unit provides a variety of pre-programmed scenarios to help responders become familiar with an AED and allows them to demonstrate the basic skills necessary to use an AED in an emergency.

RESCUE SAM TRAINER PRO provides simulated shock delivery. It has no high-voltage capabilities, and cannot deliver a shock, thereby ensuring safety during training

NOTE: Before using a real clinical AED, the responder should have completed an appropriate responder training program. Having completed such a course, they should demonstrate a proficiency in performing Basic Life Support skills; and knowledge of applicable Medical protocols and procedures.

Set Language

Insert the plug-in card to install language

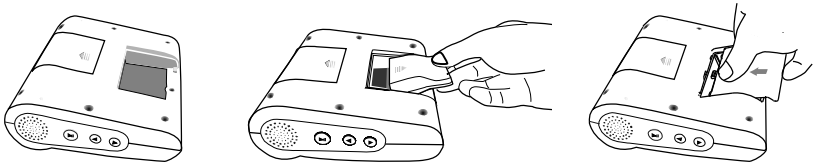

A replaceable language/scenario card is included. Users can purchase the basic unit and then buy additional plug-in cards separately for different languages, such as English, Spanish, Italian, Dutch ect. New cards will become available to support any change to AED Guidelines.

Overview

Product contents:
Main Body, Remote Control, Plug-in Card, Training Pads, Wire Connectors, Instruction Manual, Storage Bag, Adapter.

1. ON/OFF Button
2. Pads Connector Socket
3. Scenario Selection/UP
4. Scenario Selection/Down
5. Volume Control
6. Shock Button
7. DC input
8. AUDIO out
9. Pause/Play
10. Language Selection
11. Operating Scenario Display(LED)
12. Metronome (LED)
13. Speaker

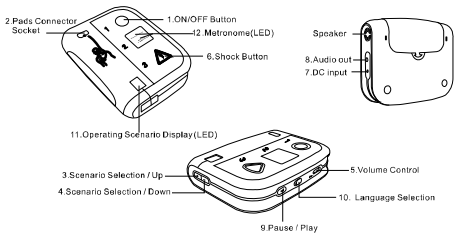

AED Trainer Main Body

1. On/Off button
   Turn unit on and initiate voice prompts. Press once to turn unit on. Press again to turn off.

2. Pads Connector Socket
   Insert the training pads connector into the pads connector socket. The
   LED flashes to indicate the socket location. The LED is covered when
   The defibrillator pad connector is properly inserted in the socket.

3. Scenario Selection/Up
   Press this button, the display prompts scenario selection from 0 to 9.

4. Scenario Selection/Down
   Press this button, the display prompts scenario selection from 9 to 0.
5. Volume Control
   Control the voice prompt volume during use.

6. Shock button
   Activate simulated shock delivery. The button flashes when the unit is ready to deliver a simulated shock.
7. DC input
   To enable the AED Trainer to run from Mains Power.
   Please use the adapter with DC 4.5V/300Ma.
   (Note: Don't use batteries while an adapter is connected)
8. Audio out
   All external speakers to be connected to the AED Trainer.



9. Pause /Play
   The pause function can temporarily stop all operations of the unit.
   Press once to pause. Press again to continue playing.
10. Language Selection
    The RESCUE SAM TRAINER PRO can be bilingual. The user can change voice prompts in different language by this toggle switch. " " or " " will be displayed in the LED display window.
11. Operating Scenario Display (LED)
    Display selected scenario number.
12. Metronome(LED)
    Flash lights when the unit is counting out the 2 minutes during CPR.

Automatic Shut Off

1. Under the 10 scenarios, if no operation after 5 circles. It will be turned off automatically.
2. If the remote control is applied, when it simulates a shockable rhythm or a non-shockable rhythm, the AED Trainer will be turned off if no

operation after 5 circles.

3. Low battery:
   During the operation, if low power is detected , it will be turned off automatically in 10 seconds.
4. When paused with no operation, the AED trainer will be turned off after 8 minutes.

Remote Control

Control buttons functions described below (please refer to the diagram.



(1. Select scenarios by numbers
(2. Scenario selection
(3. Play
(4. Pause
(5. PRE-CONNECT activate key
(6. Simulate good electrodes connection
(7. Simulate loose electrodes connection
(8. Simulate motion artifact
(9. Simulate a shockable rhythm (defibrillate)
(10. Simulate a non-shockable rhythm (non-defibrillate)
(11. Semi auto/fully auto scenarios selection
(12. Low battery
(13. Error button

1. Scenario Selection

Select scenarios by numbers

2. Scenarios Selection/Up & Down
   When either of these buttons are pressd , the display prompts a change in scenario selection.

3. Play Button: Resumes the activity from the point at which it was paused.

4. Pause Button: Freezes all activity in the trainer. Pause is indicated by ”// ”. In the LED display window.

5. PRE-CONNECT activate key (optional)
   Only used for Semi auto/Fully auto selectable program. Before the user turns unit on, if the pads have been connected firmly, it will be pre-connect Semi Auto or Pre-connect Fully Auto. The voice prompts will not continue unless the “PRE-CONNECTED activate key” has been pressed.

6. Simulate good electrodes connection
   During the training, if this button is pressed, “ ” will be displayed on the main body. It simulates good electrodes connection. The user can choose related scenarios to practice.

7. Simulate loose electrodes connection
   During the training, if this button is pressed, “ ” will be displayed on the main body. It simulates loose electrodes connection. The user can choose related scenarios to practice.

8. Simulate motion artifact
   During the training, if this button is pressed, “ ” will be displayed on the main body.

9. Simulate a non-shockable rhythm
   During the training, if this button is pressed, “ ” will be displayed on the main body. It simulates a non-shockable rhythm. The user can

choose related scenarios to practice.

10. Simulate a non-shockable rhythm
    During the training, if this button is pressed, “ “ will be displayed on the main body. It simulates a non-shockable rhythm. The user can choose related scenarios to practice.

11. Semi auto/Fully auto scenarios selection
    Select between semi automatic scenarios and fully automatic scenarios.

12. Low Battery
    During the training, if this button is pressed, “ ”will be displayed on the main body, A voice prompts “low battery”, and then the current scenario is continued.

13. Error Button:
    During the training, if this button is pressed, it gives “tick” sound, and “ ” is displayed on the main body, the voice prompts are stopped, the “Tick” sound is given again after 10 seconds and will be continued until the AED Trainer is turned off

Other Components



1. Training pads
2. Wire Connector
3. Plug-in card
4. Instruction Manual
5. Storage Bag

Battery Insertion

1) Open the battery compartment following the arrowhead direction.
2) Put in 3 AA batteries, and note the polarity. (Note: The real clinical AED maybe use different batteries.)
3) Reposition the battery compartment's cover.
4) Please use good quality batteries, to avoid malfunctions caused by leskage.
5) The AED Trainer prompts users to replace batteries when the run low.

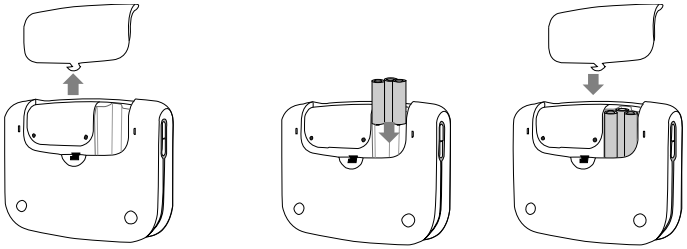

Training Pads

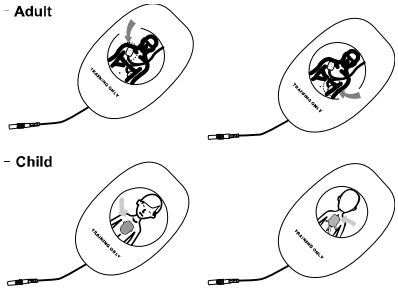

1. Adult
2. Child

Note: The training pads are for training use only and will not function with an actual clinical AED.

Operating Instruction

First, turn on the trainer and select a training scenario

Turn on the unit, then press the scenario selection button to select a preprogrammed training scenario, The operating scenario is displayed in the LED display window.

Note: The last setting will be stored and maintained even if the unit has been burned off.



Second, connect pads

1) Take out the training pads.
2) Connect the wire with training pads.
3) Place pads on the chest in the position shown on the pad disgrams. Remember, the Yellow connector is for the Adult pads, and the Pink connector is for Paediatric pads.
4) When prompted, plug the connector to the Training using the socket with a flashing orange LED.

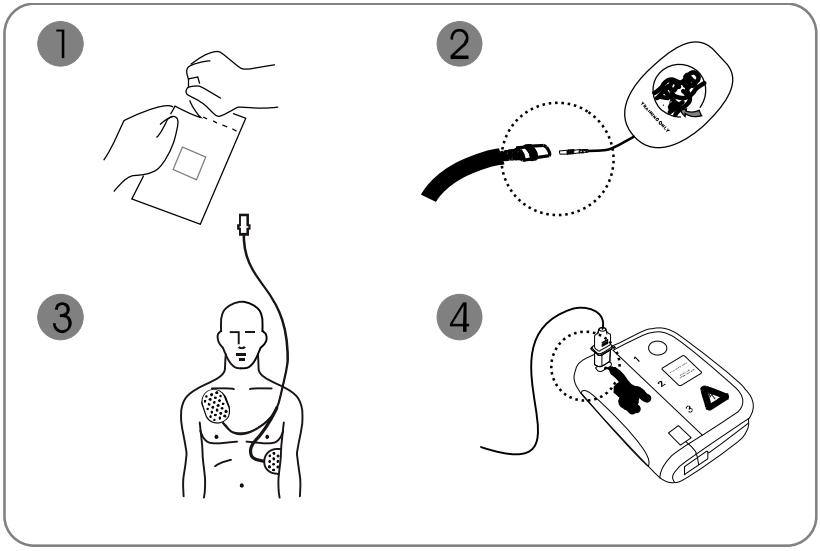

Note:

- Don’t bend or stretch wires excessively.
- Please hold the pad connector when pulling it out of the trainer

Third, follow the voice prompts

According to the selected scenario, operate the trainer by following the voice prompts.

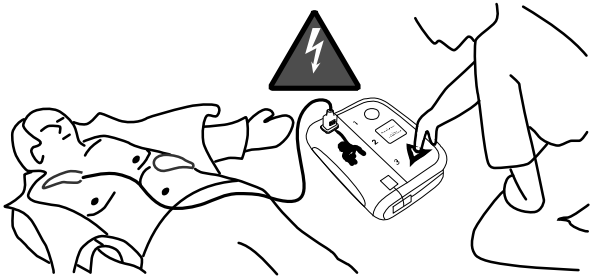

Storage Guidance

Pads Maintenance

- Keep the Gel side of pads clean and free of dust.
- After use, please stick pads with its original cover.
- If the stickiness of pads declines, user can try washing the pads with water for a few seconds, and then leaving to dry thoroughly.
- Don’t wipe the Gel side of pads with paper and cloth.
- Don’t scrape the Gel side of pads with nail and brush.
- The pads should last for several training sessions
- Don’t wash pads frequently, and don’t use detergent and hot water.
- Don’t store pads in places subjected to direct sunlight, high temperature or humidity.

Main Body Maintenance

- Wipe clean the main body routinely.
- After shutting off power, make sure to pull out the pads’ connector from the main body.
- If the main body is dirty, use a soft cloth with water of neutral detergent but must wring dry to wipe it softly, If necessary, clean or sterilize it with a cloth soaked in medical alcohol (75% concentration max.)
- Do not use abrasive cleaning substances
- Do not soak the AED training unit with any fluid use only damp non-abrasive cloths for cleaning..

Storage Precautions:

- Do not store near spirits or gasoline.
- Do not store in locations subjected to direct sunlight., high temperature, moisture, dust or corrosive gas.
- Store the main body, electrode pads, wire leads and instruction manual in the bag provided.

※ Failure to comply with the above instructions may void the warranty.

10 Preprogrammed Scenarios

10 preprogrammed scenarios in RESCUE SAM TRAINER PRO

Scenarios	Description	Operation
0	Ventricular Fibrillation-With single-shock conversion	● Shockable rhythm ● 1 shock ● Non-shockable rhythm
1	Ventricular Fibrillation-with multiple shocks required for conversion	● Shockable rhythm ● 4 shocks ● Non-shockable rhythm
2	Troubleshooting Skills-Defibrillation pads	● Poor pad connection ● Shockable rhythm ● 1 shock ● Non-shockable rhythm
3	Ventricular Fibrillation-with two shocks required for conversion	● Shockable rhythm ● 2 shock ● Non-shockable rhythm

4	Non-Shockable Rhythm	● Non-shockable rhythm throughout
5	Ventricular Fibrillation-with two shocks required for conversion	● Shockable rhythm ● 2shocks ● Non-shockable rhythm
6	Ventricular Fibrillation-with three shocks required for conversion	● Shockable rhythm ● 3 shocks ● Non-Shockable rhythm
7	Troubleshooting Skills-Defibrillation pads with two shocks required for conversion	● Poor pad connection ● Shockable rhythm ● 2 shocks ● Non-shockable rhythm
8	Ventricular Fibrillation	● Ventricular fibrillation throughout
9	Troubleshooting skills-Motion, Low battery, with one shock required for conversion	● Motion artifacts ● Shockable rhythm ● 1 shock ● Non-shockable rhythm ● Battery low

Replacement of the Language/Scenarios Card

Note: Please take out the batteries before replace the card.

1. Remove the battery cover. Unscrew the two screws on the compartment cover to access the plug in card.

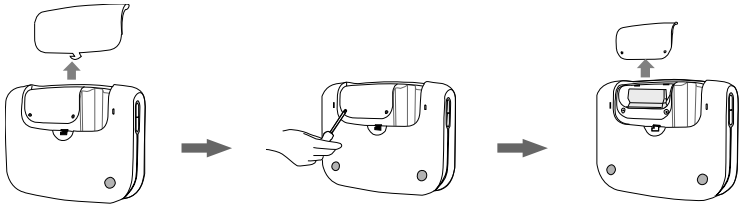

1. Use left hand to buttress the trainer body, put the thumb of right hand on the upper left side, push rightward and hard to take out of the card.

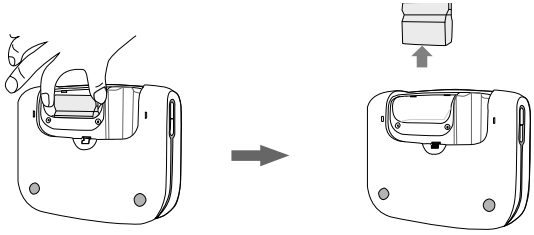

3. As showed in the following figure, use right hand go pinch the end of the card, to push inward firmly

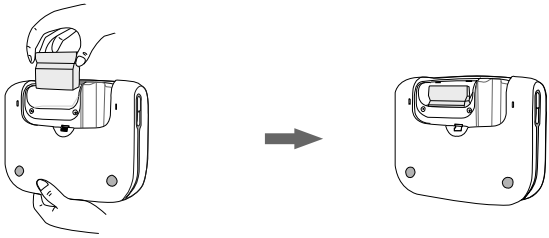

4. Replace the compartement cover and the main battery cover.
   Turn on the unit to test. If an error occurs, unplug the card and push in again.

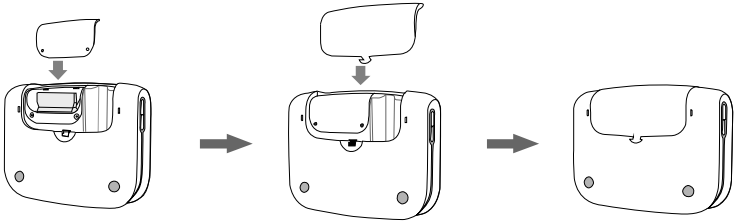

Specification and product content

Model No.: RESCUE SAL TRAINER PRO

Name: AED Trainer with Replaceable Language/Scenario Card

Power Supply: DC 4.5V/3*AA battery

Product Size:190*150*46mm

Static Current: < 200uA

Maximum Current: < 300mA

Remote Control

Power Supply: DC 3V/2*AAA battery

Static Current: < 5uA

Maximum Current: < 10mA

Product Content:

NO.	Contents	Quantity	Unit	Remark
1	Main Body	1	Pc	
2	Plug-in-Card	1	Pc	
3	Remote Control	1	Pc	
4	Wire Connector	2	Pcs	1 yellow connector, 1 pink connector

5	Adult Pads	3	Pairs	These pads can be used repeatedly
6	Child pads	2	Pairs	These pads can be used repeatedly
7	Instruction Manual	1	Pc	
8	Storge Bag	1	Pc	Nylon bag
9	Adapter	1	Pc	DC4.5/300mA

GERMAN version

1. Einschalten
2. Befolgen Sie die Anweisungen
3. Drücken Sie die Schocktaste, wenn es angewiesen wird

Mit auswechselbarer Sprache / Szenario-Karte

Gebrauchsanweisungen

Vielen Dank für den Kauf von der RESCUE SAM TRAINER PRO Trainingseinheit
Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig und gründlich, bevor Sie dieses Gerät bedienen
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf

Vorstellung des Produkts

Der Trainer RESCUE SAM TRAINER PRO ist entwickelt, um den Ersthelfer im Umgang mit einem automatischen externen Defibrillator (AED) effektiv zu trainieren. Diese Trainingseinheit bietet eine Vielzahl von vorprogrammierten Szenarien an, um dem Ersthelfer zu helfen, mit einem AED vertraut zu sein, und um ihn zu ermöglichen, die grundlegenden erforderlichen Fähigkeiten für die Verwendung vom AED im Notfall aufzuzeigen.

Der Trainer von RESCUE SAM TRAINER PRO bietet simulierte Schocks an.
Um die Sicherheit während der Ausbildung zu gewährleisten, hat das Gerät keine Fähigkeiten der Hochspannung und kann keinen Schock abgeben.

Hinweis: Bevor ein echter klinischer AED verwendet wird, sollten die Ersthelfer eine entsprechende Ausbildung vollendet haben. Nach der Vollendung eines solchen Kurses sollten sie die Fähigkeiten für die lebendrettenden Sofortmaßnahmen zeigen; und Kenntnisse der geltenden medizinischen Protokolle und Verfahren.
Sprache einstellen
Stecken Sie die Einsteckkarte, um die Sprache zu installieren

Eine auswechselbare Sprache / Szenario-Karte wird mitgeliefert. Die Anwender können die Grundeinheit kaufen, und dann die zusätzlichen Einsteckkarten getrennt für die verschiedenen Sprachen kaufen, wie Englisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch usw. Neue Karten werden zur Verfügung stehen, um jede Veränderung der AED-Richtlinien zu unterstützen.

Überblick

Inhlat des Produkts:

Hauptteil, Fernbedienung, Einsteckkarte, Schulungsbeläge, Leitungsverbinder, Bedienungsanleitung, Speicherungstasche, Adapter

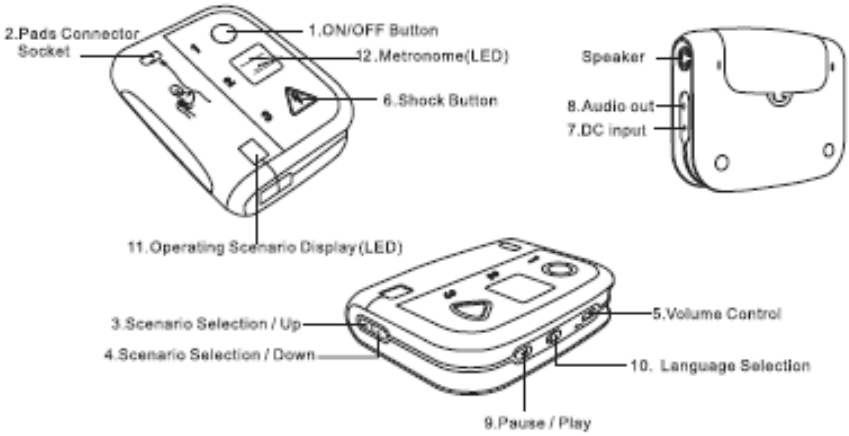

1. An-/Aus-Schalter
2. Steckdose der Beläge
3. Auswahl des Szenarios / Hinauf
4. Auswahl des Szenarios / Herunter
5. Kontrolle der Lautstärke
6. Schocktaste
7. Eingang des Gleichstroms
8. Audio-Ausgang
9. Pause / Spielen
10. Auswahl der Sprache
11. Display des Betriebsszenatios (LED)
12. Metronom (LED)

Speaker: Lautsprecher

Hauptteil vom AED-Trainer

1. An-/Aus-Schalter

Schalten Sie das Gerät ein und initiieren Sie die Sprachanweisungen. Drücken Sie es einmal, um es einzuschalten. Drücken Sie es erneut, um es auszuschalten.

2. Steckdose der Beläge

Stecken Sie den Stecker von Trainingbelägen in die Steckdose der Beläge. Das LED blinkt, um die Lage der Buchse anzuzeigen. Das LED blinkt nicht, wenn der Belag-Stecker des Defibrillators richtig in der Steckdose steckt.

3. Auswahl des Szenarios / Hinauf

Drücken Sie diese Taste, weist das Display die Auswahl von Szenarien 0-9 an.

4. Auswahl des Szenarios / Herunter

Drücken Sie diese Taste, weist das Display die Auswahl von Szenarien 0-9 an.

5.Kontrolle der Lautstärke

Steuern Sie die Lautstärke der Sprachanweisungen während der Verwendung.

6 Schocktaste

Aktivieren Sie die simulierten Schocks. Die Taste blinkt, wenn das Gerät bereit ist, einen simulierten Schock abzugeben.

7 Eingang des Gleichstroms

Um den AED-Trainer zu ermöglichen, mit der Stromversorgung des Stromnetzes zu betreiben.

Bitte benutzen Sie den Adapter mit DC4.4V/300mA.

(Hinweis: Verwenden Sie keine Batterien, wenn ein Adapter angeschlossen ist)

8 Audio-Ausgang

Alle externen Lautsprecher können an den AED-Trainer angeschlossen werden.

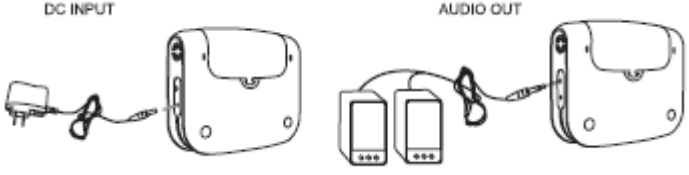

Eingang des Gleichstroms Audio-Ausgang

9.Pause / Spielen

Die Pause-Funktion können vorübergehend alle Bedienungen der Einheit verhindern.

Drücken Sie einmal zur Pause. Drücken Sie erneut, um das Spielen fortzusetzen.

10.Auswahl der Sprache

Der Trainer von RESCUE SAM TRAINER PROkann zweisprachig sein. Der Benutzer kann durch diesen Kippschalter die Sprachanweisungen in verschiedenen Sprachen wechseln. "—" oder "=" warden auf dem LED-Display angezeigt.

11.Display des Betriebsszenatios (LED)

Die Nummer des gewählten Szenarios wird angezeigt.

12.Metronom (LED)

Flash leuchtet, wenn das Gerät 2 Minuten während der CPR auszählt.

Automatische Ausschaltung

1. Wenn es unter den 10 Szenarien keinen Betrieb nach 5 Zyklen gibt, wird der AED-Trainer automatisch ausgeschaltet.
2. Wenn die Fernbedienung verwendet wird, um einen defibrillierbaren oder nicht defibrillierbaren Rhythmus zu simulieren, wird der AED-Trainer ausgeschaltet, wenn es keinen Betrieb nach 5 Zyklen gibt.

3. Niedrige Batterie:

Wenn während der Operation die geringe Energie erkannt wird, wird der AED-Trainer automatisch nach 10 Sekunden ausgeschaltet.

4. Bei der Pause ohne Betrieb wird der AED-Trainer nach 8 Minuten ausgeschaltet.

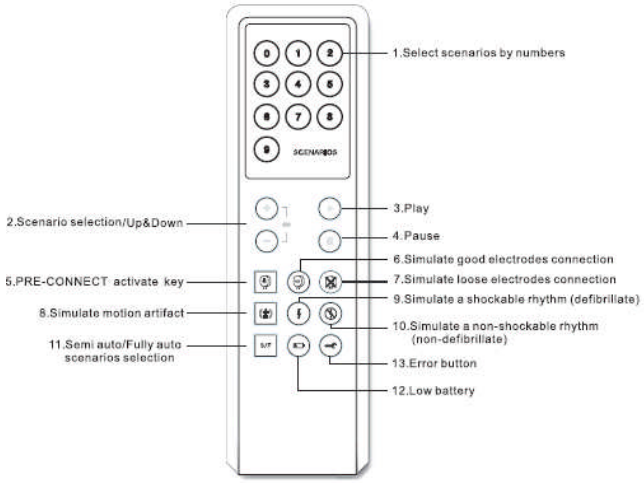

1. Auswahl der Szenarien durch die Nummern
2. Auswahl des Szenarios / Hinauf & Herunter
3. Spielen
4. Pause
5. Aktivierungstaste vom Vorher-Anschluss
6. Simulieren gute Verbindung der Elektroden
7. Simulieren schlechte Verbindung der Elektroden
8. Simulieren Bewegungsartefakte
9. Simulieren defibrillierbaren Rhythmus (defibrillieren)
10. Simulieren nicht-defibrillierbaren Rhythmus (nicht defibrillieren)
11. Auswahl des halbautomatischen / vollautomatischen Szenarios
12. Niedrige Batterie
13. Fehlertaste

1. Auswahl der Szenarien durch die Nummern

Die Szenarien durch die Nummern auswählen.

2. Auswahl des Szenarios / Hinauf & Herunter

Wenn eine dieser Tasten gedrückt wird, weist das Display eine Veränderung in derAuswahl von Szenarien an.

3. Taste des Spielens: Setzen Sie die Aktion von dem Punkt, an dem sie unterbrochen wurde, fort.
4. Taste der Pause: Alle Aktivitäten im Trainer wird gestoppt. Pause wird durch "II" im Fenster des LED-Displays angezeigt
5. Aktivierungstaste vom Vorher-Anschluss

Nur für halbautomatische / vollautomatische wählbare Programme verwendet. Bevor der Anwender das Gerät einschaltet, wenn die Beläge fest miteinander verbunden haben, werden, wird es halbautomatischer Vorher-Anschluss oder vollautomatischer Vorher-Anschluss sein. Die Sprachanweisungen werden nicht fortdauern, wenn „Aktivierungstaste vom Vorher-Anschluss“ nicht gedrückt wird.

6. Simulieren gute Verbindung der Elektroden

Wenn während des Trainings diese Taste gedrückt wird, wird "H" auf dem Hauptteil dargestellt. Es simuliert eine gute Verbindung der Elektroden. Der Anwender kann die in Verbindung stehenden Szenarien für die Übung auswählen.

7. Simulieren schlechte Verbindung der Elektroden

Wenn während des Trainings diese Taste gedrückt wird, wird "F" auf dem Hauptteil dargestellt. Es simuliert eine schlechte Verbindung der Elektroden. Der Anwender kann die in Verbindung stehenden Szenarien für die Übung auswählen.

8. Simulieren Bewegungsartefakte
9. Wenn während des Trainings diese Taste gedrückt wird, wird "=" auf dem Hauptteil dargestellt.
10. Simulieren defibrillierbaren Rhythmus (defibrillieren)

Wenn während des Trainings diese Taste gedrückt wird, wird "C" auf dem

Hauptteil dargestellt. Es simuliert einen defibrillierbaren Rhythmus. Der Anwender kann die in Verbindung stehenden Szenarien für die Übung auswählen.

11. Simulieren nicht-defibrillierbaren Rhythmus (nicht defibrillieren)

Wenn während des Trainings diese Taste gedrückt wird, wird "∩" auf dem Hauptteil dargestellt. Es simuliert einen nicht-defibrillierbaren Rhythmus. Der Anwender kann die in Verbindung stehenden Szenarien für die Übung auswählen.

12. Auswahl des halbautomatischen / vollautomatischen Szenarios

Zwischen dem halbautomatischen / vollautomatischen Szenario auswählen.

13. Niedrige Batterie

Wenn während des Trainings diese Taste gedrückt wird, wird "L" auf dem Hauptteil dargestellt. Eine Stimm weist „niedrige Batterie“ an, und dann wird das aktuelle Szenario fortgesetzt.

14. Fehlertaste

Wenn während des Trainings diese Taste gedrückt wird, wird eine „dicke“ Stimme gegeben, und "E" wird auf dem Hauptteil dargestellt, die Stimmeanweisung wird gestoppt, die „dicke“ Stimme wird nach 10 Sekundne erneut gegeben und fortgesetzt, bis der AED-Trainer ausgeschaltet wird.

Andere Komponenten

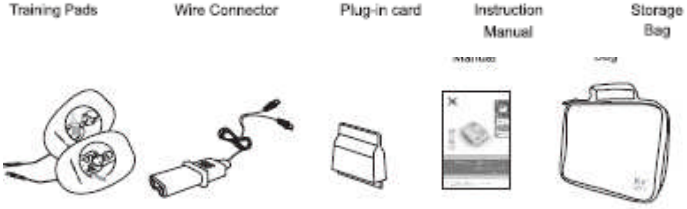

Trainingsbeläge
Leitungsverbinder
Einsteckkarte
Bedienungsanleitung
Speicherungstasche

Einstecken der Batterie

1) Öffnen Sie das Batteriefach nach der Richtung der Pfeilspitze.

2) Drei AA-Batterien stecken, und beachten Sie die Polarität. (Hinweis: Der reale klinische AED kann unterschiedliche Batterien verwenden).

3) Positionieren Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

4) Bitte verwenden Sie die Batterien guter Qualität, um die Fehlfunktionen wegen des Lecks zu verhindern.

5) Der AED-Trainer fordert den Benutzer auf, die Batterien zu ersetzen, wenn die Batterie niedrig ist.

Training-Beläge

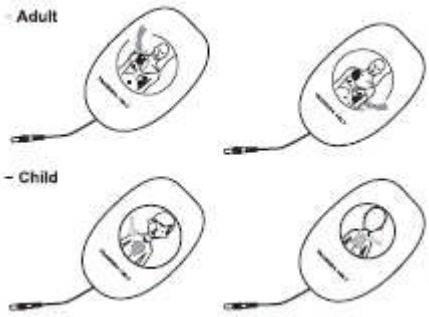

- Erwachsene
- Kinder

Hinweis: Die Training-Beläge sind für die Zwecke vom Training verwendet und werden nicht mit einem tatsächlichen klinischen AED funktionieren.

Bedienungsanleitung

Erstens schalten Sie den Trainer ein und wählen Sie ein Szenario des Trainings aus.

Schalten Sie das Gerät ein, und drücken Sie dann die Auswahltaste des Szenarios, um ein vorprogrammiertes Trainingsszenario auszuwählen. Das Betriebsszenario wird auf dem LED-Display angezeigt.

Hinweis: Die letzte Einstellung wird gespeichert und gepflegt werden, auch wenn das Gerät ausgeschaltet wurde.

Zweitens: Schließen Sie die Beläge an

1) Nehmen Sie die Training-Beläge

2) Verbinden Sie das Kabel mit den Training-Belägen

3) Platzieren Sie die Beläge auf der Brust in der Lage, die auf den Diagrammen der Beläge dargestellt wird.

Denken Sie daran, der gelbe Stecker ist für die Beläge der Erwachsenen, und der rosa Stecker ist für die pädiatrischen Beläge.

4) Wenn Sie angewiesen werden, stecken Sie den Stecker in den AED-Trainer über die Steckdose mit einem orangen blinkenden LED.

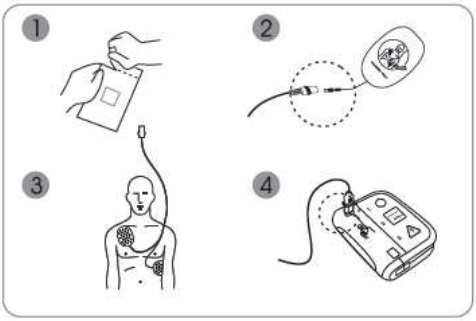

Hinweis:

Biegen oder dehnen Sie die Kabel nicht übermäßig.

Bitte halten Sie die Belag-Stecker, wenn Sie ihn aus dem Trainer herauziehen.

Drittens, befolgen Sie die Sprachanweisungen.

Je nach gewähltem Szenario, bedienen Sie den Trainer nach den Sprachanweisungen.

Anleitung für die Lagerung

Wartung des Belags

Halten Sie die Gelseite des Belags sauber und frei von Staub.

Nach dem Gebrauch kleben Sie bitte den Belag mit ihrer originalen Abdeckung.

Wenn die Klebrigkeit des Belags sinkt, können die Benutzer versuchen, mit dem Wasser den Belag für ein paar Sekunden zu waschen und dann gut trocknen zu lassen.

Wischen Sie die Gelseite des Belags nicht mit dem Papier und Tuch.

Kratzen die Gelseite des Belags nicht mit dem Nagel und Pinsel.

Die Beläge sollten für mehrere Trainingseinheiten dauern.

Waschen Sie die Beläge nicht häufig, und verwenden Sie keine Spülmittel und kein heißes Wasser.

Bewahren Sie die Beläge nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit.

Wartung des Hauptteils

Wischen Sie den Hauptteil routinemäßig.

Nach der Ausschaltung des Geräts stellen Sie sicher, den Stecker des Belags aus dem Hauptteil zu ziehen.

Wenn der Hauptteil verschmutzt ist, verwenden Sie ein weiches und feuchtes Tuch mit Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel, und wischen Sie den Hauptteil sanft. Wenn nötig, reinigen oder sterilisieren Sie den Hauptteil mit einem Tuch, das im medizinischen Alkohol getränkt wurde (75% Konzentration max.)

Benutzen Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Verwenden Sie nur feuchtes und nicht scheuerndes Tuch zur Reinigung. Weichen Sie die AED-Trainingseinheit nicht mit der Flüssigkeit ein.

Vorsichtsmaßnahmen für die Lagerung

Lagern Sie das Gerät nicht in der Nähe vom Spiritus oder Benzin.

Lagern Sie das Gerät nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung, hoher Temperatur, der Feuchtigkeit, dem Staub oder dem ätzenden Gas.

Lagern Sie den Hauptteil, die Elektroden, die Kabelleitung und die Bedienungsanleitung in der zur Verfügung gestellten Tasche.

Die Nichtbeachtung der obenerwähnten Anleitungen kann die Garantie ungültig machen.

10 Vorprogrammierte Szenarien

10 vorprogrammierte Szenarien im Trainer von RESCUE SAM TRAINER PRO

Szenarien	Beschreibung	Bedienung
0	Herzkammerflimmern - mit einzelner Schock der Umwandlung	Defibrillierbarer Rhythmus 1 Schock Nicht defibrillierbarer Rhythmus
1	Herzkammerflimmern - mit mehreren Schocks für die Umwandlung	Defibrillierbarer Rhythmus 4 Schocks Nicht defibrillierbarer Rhythmus
2	Fähigkeiten der Fehlersuch – Belag der Defibrillation	Schlechte Verbindung des Belags Defibrillierbarer Rhythmus 1 Schock Nicht defibrillierbarer

		Rhythmus
3	Herzkammerflimmern - Mit zwei Schocks für die Umwandlung	Defibrillierb arer Rhythmus 2 Schocks Nicht defibrillierb arer Rhythmus
4	Nicht defibrillierbarer Rhythmus	Nicht defibrillierb arer Rhythmus Immer
5	Herzkammerflimmern - Mit zwei Schocks für die Umwandlung	Defibrillierb arer Rhythmus 2 Schocks Nicht defibrillierb arer Rhythmus
6	Herzkammerflimmern - Mit drei Schocks für die Umwandlung	Defibrillierb arer Rhythmus 3 Schocks Nicht defibrillierb arer Rhythmus
7	Fähigkeiten der Fehlersuch – Belag der Defibrillation mit zwei Schocks für die Umwandlung	Schlechte Verbindung des Belags

		Defibrillierbarer Rhythmus 2 Schocks Nicht defibrillierbarer Rhythmus
8	Herzkammerflimmern	Herzkammerflimmern Immer
9	Fähigkeiten der Fehlersuch – Bewegung, niedrige Batterie, mit einem Schock für die Umwandlung	Bewegungsartefakte Defibrillierbarer Rhythmus 1 Schock Nicht defibrillierbarer Rhythmus Batterie niedrig

Auswechselung der Sprache / Szenariokarte

Hinweis: Nehmen Sie bitte die Batterien heraus, bevor Sie die Karte wechseln.

1. Entfernen Sie die Abdeckung der Batterie. Lösen Sie die zwei Schrauben auf der Abdeckung des Fachs, um auf die Einsteckkarte zuzugreifen.

2. Benutzen die linke Hand, um den Körper des Trainers zu unterstützen, legen Sie den Daumen der rechten Hand auf die obere linke Seite, schieben Sie es seitlich schwer, um die Karte herauszunehmen.

3. Wie in der folgenden Abbildung gezeigt, verwenden Sie die rechte Hand, um die Karte zu greifen, und nach innen fest zu drücken.

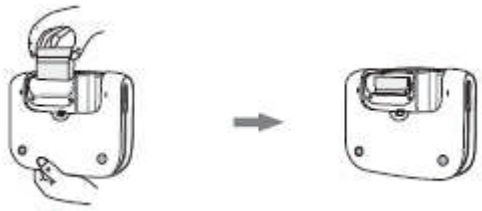

3. Wechseln Sie die Abdeckung des Fachs und die Abdeckung der hauptsätzlichen Batterie aus. Schalten Sie das Gerät ein, um es zu prüfen. Wenn ein Fehler auftritt, ziehen Sie die Karte aus und drücken Sie die Karte erneut darin.

Spezifikation und Inhalte des Produkts:

Nummer des Modells: RESCUE SAM TRAINER PRO
Bezeichnung: Der AED-Trainer mit auswechselbarer Sprache / Szenario-Karte
Stromversorgung: DC 4.5V / 3 AA-Batterien
Größe des Produkts: 190*150*46 mm

Statischer Strom: < 5μA

Maximaler Strom: < 300mA

Fernbedienung
Stromversorgung: DC 3V / 2 AAA-Batterien

Statischer Strom: < 5μA

Maximaler Strom: < 10mA

Inhalte des Produkts:

Nr.	Inhalte	Menge	Einheit	Bemerkung:
1	Hauptteil	1	pc	
2	Einsteckkarte	1	pc	
3	Fernbedienung	1	pc	
4	Leitungsverbinder	2	pcs	Ein gelber stecker, ein rosa stecker
5	Beläge für Erwachsene	3	Paare	Diese Beläge könner

				wiederhot verwendet werden.
6	Beläge für Kinder	2	Paa re	Diese Beläge könner wiederhot verwendet werden.
7	Bedienungsanleitung	1	Pc	
8	Speicherungstasche	1	Pc	Tasche aus Nylon
9	Adapter	1	pc	DC 4.5V / 300mA